

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"

	AREA DE APLICACION		FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
	LABORATORIO (URIANALISIS)		15/05/2013	
	NOMBRE DEL MANUAL		Página 1 de 18	
	MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS		CLAVE	VERSIÓN
	TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO		MP-SDADLP-007	0
	CLIENTE		PRODUCTO	
TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO		LECTURA DE ORINAS EN TIRA REACTIVA		



**HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA
DR JUAN I. MENCHACA**

Elaboró	Aprobó	Revisó	Autorizó
Dr. En C. Fernando A. Velarde R. Dr. Gustavo R. Rodríguez G.	DR. Luis Alberto Ibarra Verdugo Sub- Director de Diagnóstico y Tto.	Lic. Beatriz Gutiérrez M. Gerente de Calidad	Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa Director de la Unidad

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"

	AREA DE APLICACION		FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
	LABORATORIO (URIANALISIS)		15/05/2013	
	NOMBRE DEL MANUAL		Página 2 de 18	
	MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS		CLAVE	VERSIÓN
	TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO		MP-SDADLP-007	0
	CLIENTE		PRODUCTO	
TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO		LECTURA DE ORINAS EN TIRA REACTIVA		

MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS



<p>Elaboró</p> <p>Dr. En C. Fernando A. Velarde R. Dr. Gustavo R. Rodríguez G.</p>	<p>Aprobó</p> <p>DR. Luis Alberto Ibarra Verdugo Sub- Director de Diagnóstico y Tto.</p>	<p>Revisó</p> <p>Lic. Beatriz Gutiérrez M. Gerente de Calidad</p>	<p>Autorizó</p> <p>Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa Director de la Unidad</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"



	AREA DE APLICACION	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
	LABORATORIO (URIANALISIS)	15/05/2013	
	NOMBRE DEL MANUAL	Página 3 de 18	
	MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS	CLAVE	VERSIÓN
	CLIENTE	PRODUCTO	
	TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO	LECTURA DE ORINAS EN TIRA REACTIVA	

INTRODUCCION

El analizador de orina Clinitek Advantus es un analizador semiautomático de sobremesa. Se ha diseñado para leer tiras reactivas para análisis de orina. El analizador es un espectrómetro de reflectancia que analiza el color y la intensidad de la luz reflejada en el área reactiva y comunica los resultados en unidades con significado clínico. El analizador puede determinar y comunicar el color de la orina. Usted podrá especificar el aspecto de cada muestra y no tendrá que realizar ningún cálculo.

Elaboró	Aprobó	Revisó	Autorizó
Dr. En C. Fernando A. Velarde R. Dr. Gustavo R. Rodríguez G.	DR. Luis Alberto Ibarra Verdugo Sub- Director de Diagnóstico y Tto.	Lic. Beatriz Gutiérrez M. Gerente de Calidad	Dr. Francisco Martin Preciado Figueroa Director de la Unidad

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"



	AREA DE APLICACION	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
	LABORATORIO (URIANALISIS)	15/05/2013	
	NOMBRE DEL MANUAL	Página 4 de 18	
	MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS	CLAVE	VERSIÓN
	CLIENTE	MP-SDADLP-007	0
	TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO	PRODUCTO	
	LECTURA DE ORINAS EN TIRA REACTIVA		



PARTES QUE LO CONFORMA:


- 1.- Pantalla
- 2.- Impresora
- 3.- Contenedor de desechos
- 4.- Plataforma fija
- 5.- Estación de incubación/lectura
- 6.- Estación para carga de tiras

Elaboró	Aprobó	Revisó	Autorizó
Dr. En C. Fernando A. Velarde R. Dr. Gustavo R. Rodríguez G.	DR. Luis Alberto Ibarra Verdugo Sub- Director de Diagnóstico y Tto.	Lic. Beatriz Gutiérrez M. Gerente de Calidad	Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa Director de la Unidad

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"

	AREA DE APLICACION	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
	LABORATORIO (URIANALISIS)	15/05/2013	
	NOMBRE DEL MANUAL	Página 5 de 18	
	MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS	CLAVE	VERSIÓN
	CLIENTE	MP-SDADLP-007	0
	TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO	PRODUCTO	
		LECTURA DE ORINAS EN TIRA REACTIVA	

7.- Barra impulsora

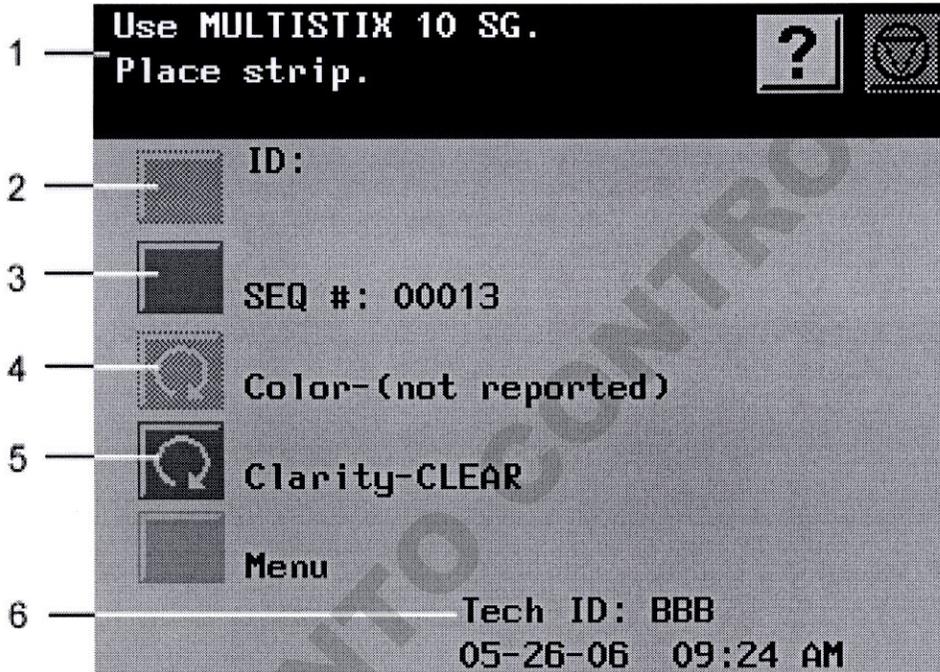

PARTES QUE CONFORMA LA PANTALLA TACTIL:

- 1.-Área de información e instrucciones
- 2.- Tecla de acción inactiva
- 3.- Tecla de acción activa
- 4.- Tecla cíclica inactiva
- 5.- Tecla cíclica activa
- 6.- Área de estado del sistema


Elaboró	Aprobó	Revisó	Autorizó
Dr. En C. Fernando A. Velarde R. Dr. Gustavo R. Rodríguez G.	DR. Luis Alberto Ibarra Verdugo Sub- Director de Diagnóstico y Tto.	Lic. Beatriz Gutiérrez M. Gerente de Calidad	Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa Director de la Unidad

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"

	AREA DE APLICACION	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
	LABORATORIO (URIANALISIS)	15/05/2013	
	NOMBRE DEL MANUAL	Página 6 de 18	
	MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS	CLAVE	VERSIÓN
	CLIENTE	MP-SDADLP-007	0
	TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO	PRODUCTO	
		LECTURA DE ORINAS EN TIRA REACTIVA	

INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO, USO Y PROCESO DE CONTROLES COMO MUESTRAS:


1.- VAMOS A COLOCAR LAS PARTES QUE SE CONFORMA LA PLATAFORMA FIJA (1), LA BARRA IMPULSADORA (2), LA ESTACION DE CARGA DE TIRAS (3) Y EL CONTENEDOR DE TIRAS DE DESECHO.

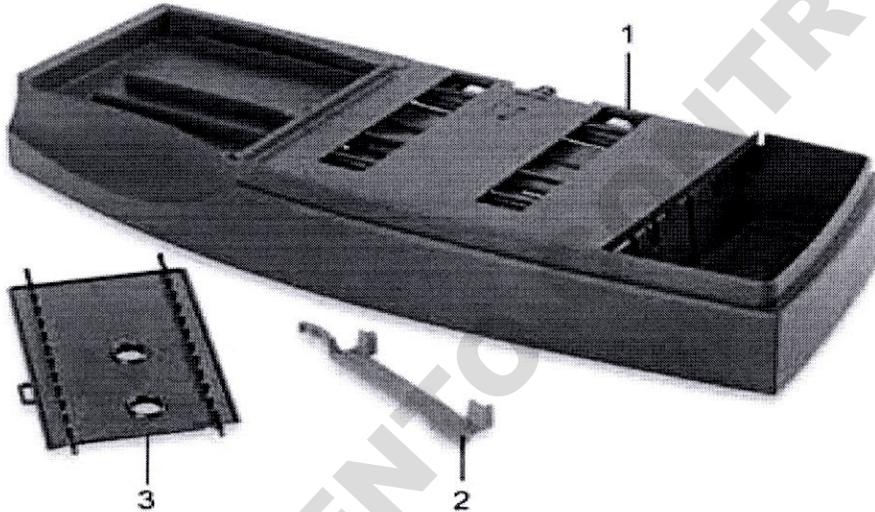


Elaboró Dr. En C. Fernando A. Velarde R. Dr. Gustavo R. Rodríguez G.	Aprobó DR. Luis Alberto Ibarra Verdugo Sub- Director de Diagnóstico y Tto.	Revisó Lic. Beatriz Gutiérrez M. Gerente de Calidad	Autorizó Dr. Francisco Martin Preciado Figueroa Director de la Unidad
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"





	AREA DE APLICACION	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
	LABORATORIO (URIANALISIS)	15/05/2013	
	NOMBRE DEL MANUAL	Página 7 de 18	
	MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS	CLAVE	VERSIÓN
	CLIENTE	MP-SDADLP-007	0
	TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO	PRODUCTO	
	LECTURA DE ORINAS EN TIRA REACTIVA		

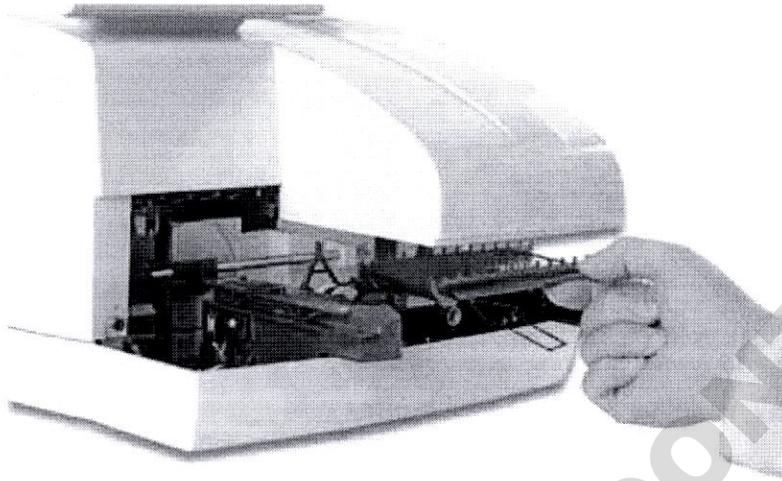

A) COLOCAMOS LA ESTACION DE CARGA DE TIRAS

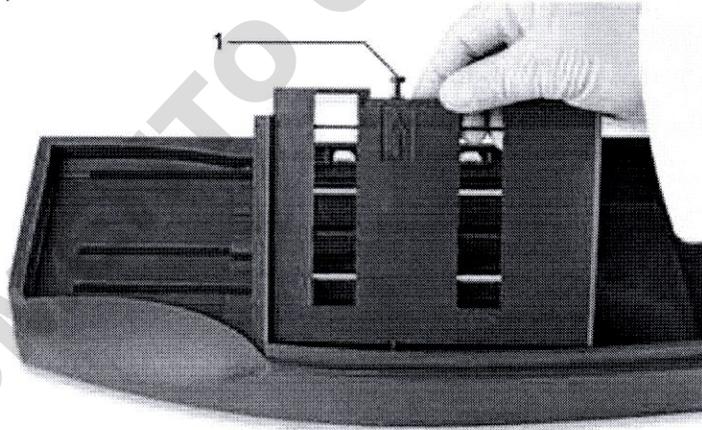


B) COLOCAMOS LA TAPA DE LA PLATAFORMA FIJA O TAMBIEN LLAMADA TAPA DE SUJECION.

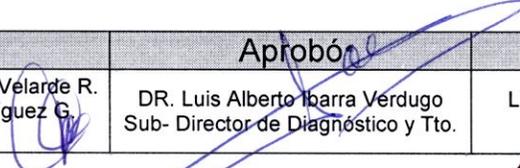			
Elaboró	Aprobó	Revisó	Autorizó
Dr. En C. Fernando A. Velarde R. Dr. Gustavo R. Rodríguez G.	DR. Luis Alberto Ibarra Verdugo Sub- Director de Diagnóstico y Tto.	Lic. Beatriz Gutiérrez M. Gerente de Calidad	Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa Director de la Unidad


O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"



	AREA DE APLICACION	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
	LABORATORIO (URIANALISIS)	15/05/2013	
	NOMBRE DEL MANUAL	Página 8 de 18	
	MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS	CLAVE	VERSIÓN
	CLIENTE	MP-SDADLP-007	0
	TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO	PRODUCTO	
	LECTURA DE ORINAS EN TIRA REACTIVA		

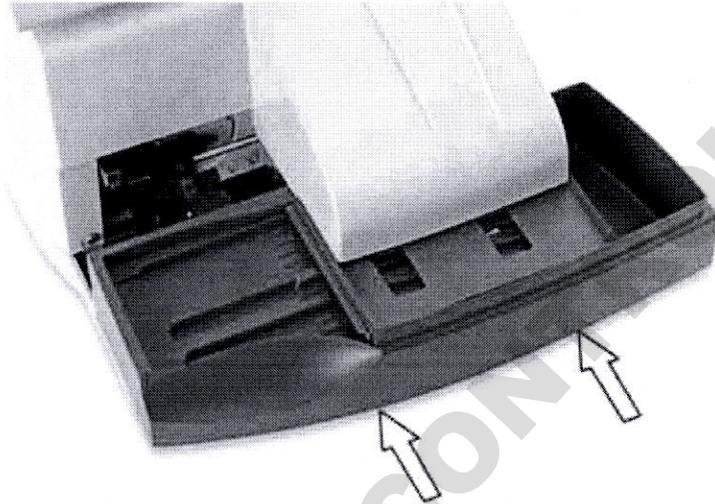

C) LA INTRODUCIMOS AL EQUIPO LA PLATAFORMA FIJA

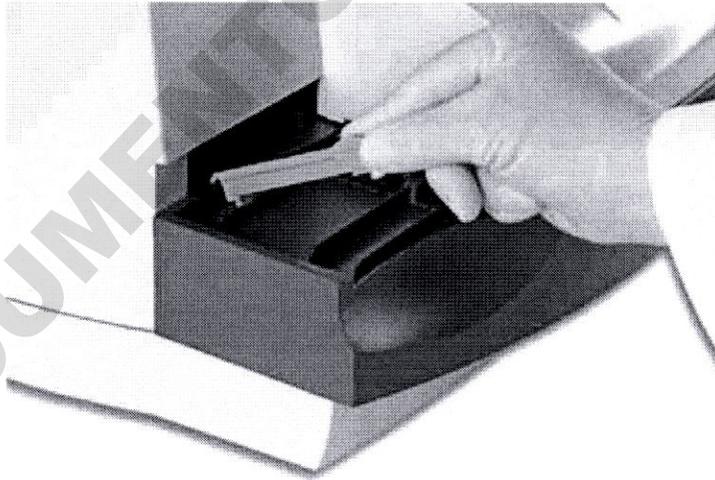


D) COLOCAMOS LA BARRA IMPULSORA

Elaboró	Aprobó	Revisó	Autorizó
Dr. En C. Fernando A. Velarde R. Dr. Gustavo R. Rodríguez G.	DR. Luis Alberto Ibarra Verdugo Sub- Director de Diagnóstico y Tto.	Lic. Beatriz Gutiérrez M. Gerente de Calidad	Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa Director de la Unidad

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"



	AREA DE APLICACION	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
	LABORATORIO (URIANALISIS)	15/05/2013	
		Página 9 de 18	
	NOMBRE DEL MANUAL	CLAVE	VERSIÓN
	MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS	MP-SDADLP-007	0
	CLIENTE	PRODUCTO	
TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO	LECTURA DE ORINAS EN TIRA REACTIVA		

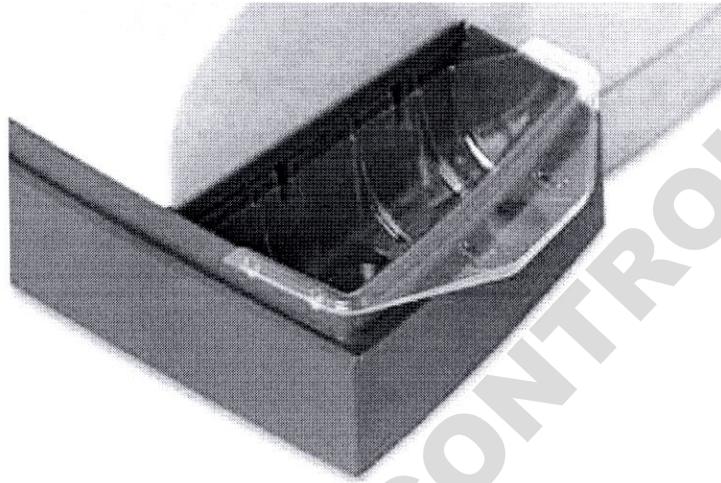

E) POR ULTIMO EL RECEPTACULO DE LAS TIRAS USADAS

2.-VAMOS A ENCENDER CON EL INTERRUPTOR EL EQUIPO POR LA PARTE LATERAL.

3.- REALIZARA UNA SERIE DE MOVIMIENTOS PARA CHECAR SUS PARTES Y SU ONDAS DE LUZ.

4.- VAMOS A TENER A LA MANO LOS CONTROLES CHEK- STIX.

Elaboró Dr. En C. Fernando A. Velarde R. Dr. Gustavo R. Rodríguez G.	Aprobó DR. Luis Alberto Ibarra Verdugo Sub- Director de Diagnóstico y Tto.	Revisó Lic. Beatriz Gutiérrez M. Gerente de Calidad	Autorizó Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa Director de la Unidad
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"

	AREA DE APLICACION	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
	LABORATORIO (URIANALISIS)	15/05/2013	
	NOMBRE DEL MANUAL	Página 10 de 18	
	MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS	CLAVE	VERSIÓN
	CLIENTE	MP-SDADLP-007	0
	TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO	PRODUCTO	
	LECTURA DE ORINAS EN TIRA REACTIVA		



5.-COLOCAMOS 12 ML. DE AGUA BIDESTILADA Y DESIONIZADA EN UN TUBO CON TAPON (2).

6.- INTRODUCIMOS LA TIRA CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO DENTRO DE CADA TUBO Y AGITAMOS POR INVERSION SUAVEMENTE POR 2 MIN.


7.- DEJAMOS 30 MINUTOS DE REPOSO.

8.- SACAMOS LAS TIRAS DE LOS TUBOS AGITAMOS DE NUEVO.

Elaboró	Aprobó	Revisó	Autorizó
Dr. En C. Fernando A. Velarde R. Dr. Gustavo R. Rodríguez G.	DR. Luis Alberto Ibarra Verdugo Sub- Director de Diagnóstico y Tto.	Lic. Beatriz Gutiérrez M. Gerente de Calidad <i>B. Gutiérrez</i>	Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa Director de la Unidad

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"

	AREA DE APLICACION	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
	LABORATORIO (URIANALISIS)	15/05/2013	
	NOMBRE DEL MANUAL	Página 11 de 18	
	MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS	CLAVE	VERSIÓN
	CLIENTE	MP-SDADLP-007	0
	TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO	PRODUCTO	
	LECTURA DE ORINAS EN TIRA REACTIVA		

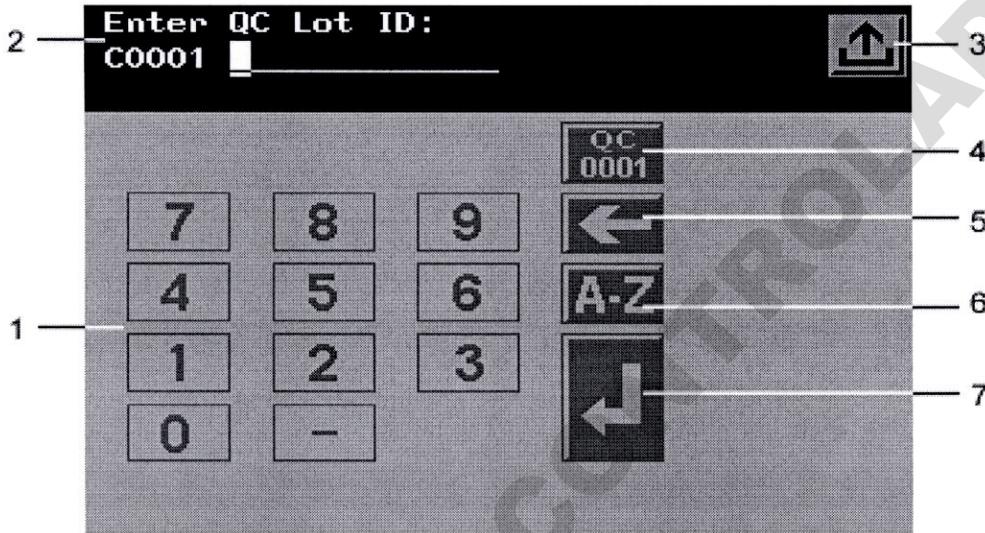

9.-PROGRAMAR LOS CONTROLES EN LA PANTALLA UTILIZANDO LAS TECLAS SEÑALADAS CON EL 4, 1, 7 DEL EQUIPO.



10.- VAMOS A COLOCAR LAS TIRAS EN LA PLATAFORMA FIJA COMO ES SEÑALADO EN LA IMAGEN Y ESPERAMOS A QUE LA ARASTRE PARA SU LECTURA EN EL ESPECTRO INTERNO Y ESPERAMOS LOS RESULTADOS ESPERADOS.

Elaboró	Aprobó	Revisó	Autorizó
Dr. En C. Fernando A. Velarde R. Dr. Gustavo R. Rodríguez G.	DR. Luis Alberto Ibarra Verdugo Sub- Director de Diagnóstico y Tto.	Lic. Beatriz Gutiérrez M. Gerente de Calidad <i>Beatriz M.</i>	Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa Director de la Unidad

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"



	AREA DE APLICACION	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
	LABORATORIO (URIANALISIS)	15/05/2013	
	NOMBRE DEL MANUAL	Página 12 de 18	
	MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS	CLAVE	VERSIÓN
	CLIENTE	MP-SDADLP-007	0
	TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO	PRODUCTO	
	LECTURA DE ORINAS EN TIRA REACTIVA		

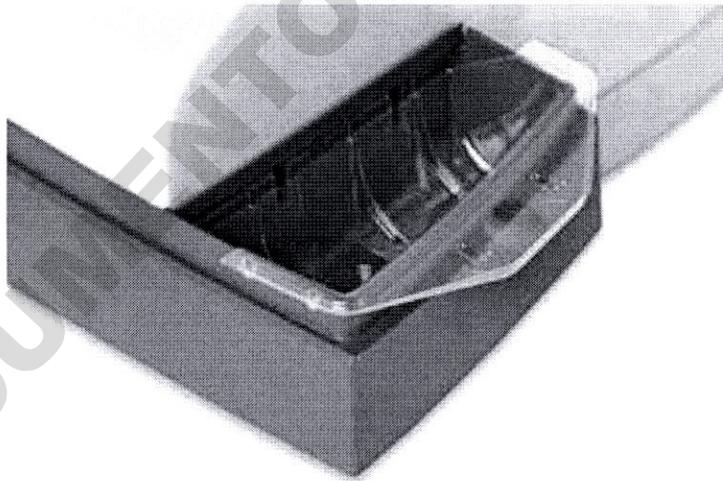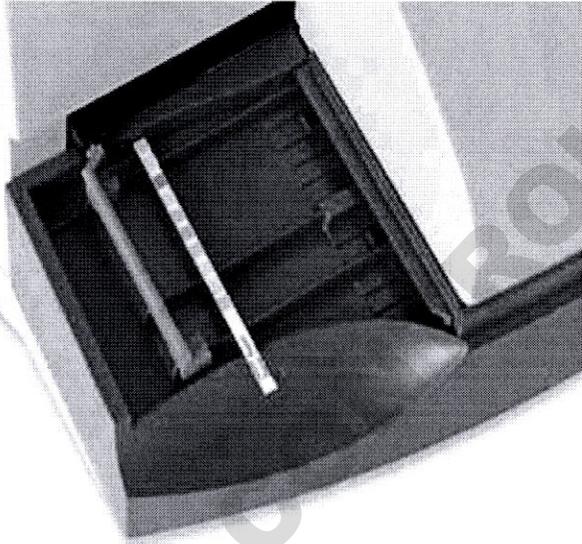

11.- UNA VEZ LEIDA LA TIRA ES DEPOSITADA EN EL CONTENEDOR DE TIRAS QUE SERAN HASTA EL FINAL DE LA JORNADA QUE SE TIREN.

Elaboró	Aprobó	Revisó	Autorizó
Dr. En C. Fernando A. Velarde R. Dr. Gustavo R. Rodríguez G.	DR. Luis Alberto Ibarra Verdugo Sub- Director de Diagnóstico y Tto.	Lic. Beatriz Gutiérrez M. Gerente de Calidad	Dr. Francisco Martín Preciado-Figueroa Director de la Unidad

Beatriz M.

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"


	AREA DE APLICACION	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
	LABORATORIO (URIANALISIS)	15/05/2013	
	NOMBRE DEL MANUAL	Página 13 de 18	
	MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS	CLAVE	VERSIÓN
	CLIENTE	MP-SDADLP-007	0
	TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO	PRODUCTO	
	LECTURA DE ORINAS EN TIRA REACTIVA		

12.- UNA VEZ VERIFICADO LOS RESULTADOS EN EL INSERTO DEL KIT DE LOS CONTROLES Y ESPERANDO LOS RESULTADOS OPTIMOS PROCEDEMOS A TRABAJAR CON LAS MUESTRAS.

13.- VAMOS A ROTULAR LOS TUBOS EN DONDE SERAN VACIADAS LAS MUESTRAS CON SU CODIGO DE BARRAS. YA QUE CADA MUESTRA CUENTA CON UN CODIGO DE BARRAS QUE ES PUESTO DESDE LA RECEPCION DEL PACIENTE EL CUAL CONTIENE EL NOMBRE DEL PACIENTE, FECHA DE NACIMIENTO, EL NUMERO QUE LE CORRESPONDE COMO PACIENTE Y SERVICIO DEL CUAL VIENE.

14.-SE AGITAN LAS MUESTRAS Y SE VERIFICA EL CODIGO DE BARRAS DEL TUBO CON EL FRASCO Y SE VACIAN LAS MUESTRAS.

15.- VAMOS A PROGRAMAR LAS MUESTRAS UTILIZANDO YA SEA LA PANTALLA TACTIL O UTILIZAR EL LECTOR DEL CODIGO DE BARRAS. COMPLEMENTO ADAPTADO PARA EL EQUIPO PARA MAYOR RAPIDEZ Y NO TENER ERRORES AL PROGRAMAR.

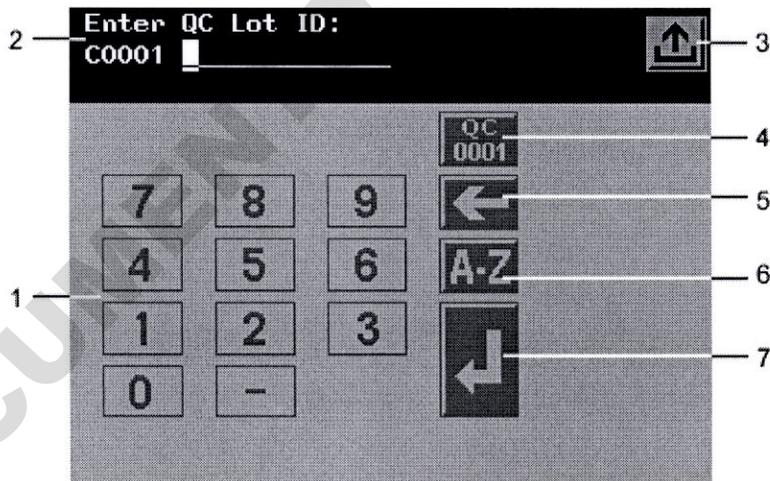

16.- UNA VEZ PROGRAMADAS TODAS LAS MUESTRAS DE ORINA CON EL NUMERO QUE LE CORRESPONDE .OPRIMIMOS EN LA PANTALLA TACTIL LA PARTE SEÑALADA CON EL NUMERO 3 EN LA IMAGEN ANTERIOR.


17.- EL EQUIPO INICIA A PEDIR LAS TIRAS POR SU NUMERO QUE LE CORRESPONDE.

Elaboró	Aprobó	Revisó	Autorizó
Dr. En C. Fernando A. Velarde R. Dr. Gustavo R. Rodríguez G.	DR. Luis Alberto Ibarra Verdugo Sub- Director de Diagnóstico y Tto.	Lic. Beatriz Gutiérrez M. Gerente de Calidad	Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa Director de la Unidad

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"

	AREA DE APLICACION	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
	LABORATORIO (URIANALISIS)	15/05/2013	
	NOMBRE DEL MANUAL	Página 14 de 18	
	MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS	CLAVE	VERSIÓN
	CLIENTE	MP-SDADLP-007	0
	TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO	PRODUCTO	
		LECTURA DE ORINAS EN TIRA REACTIVA	

18.-EL NUMERO ES PUESTO EN EL LUGAR COMO SEÑALADO CON EL NUMERO 2 DE LA SIGUIENTE IMAGEN.

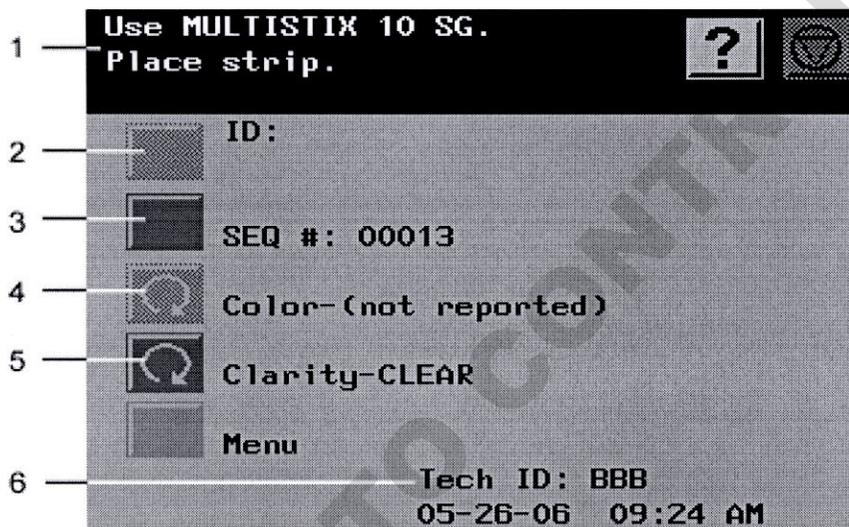

19.- UNA VEZ ARRASTRADA LA TIRA SE DEPOSITA OTRA EN LA PLATAFORMA FIJA, UNA VEZ LEIDA ES ELIMINADA EN EL CONTENEDOR DE TIRAS QUE SERA DESECHADA AL FINAL DE LA JORNADA.

20.- TODA LA INFORMACION OBTENIDA DE LAS TIRAS ES VACIADA EN LA INTERFASE EXTERNA EL CUAL SERA VISTA CUANDO SE REALICE LA REVISION Y VALIDACION DE LOS RESULTADOS.

INTRUCCIONES DE DESARMADO Y LAVADO DEL SISTEMA DIARIO.


1.- APAGAMOS EL EQUIPO POR LA PARTE LATERAL DEL EQUIPO.

Elaboró	Aprobó	Revisó	Autorizó
Dr. En C. Fernando A. Velarde R. Dr. Gustavo R. Rodríguez G.	DR. Luis Alberto Ibarra Verdugo Sub- Director de Diagnóstico y Tto.	Lic. Beatriz Gutiérrez M. Gerente de Calidad	Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa Director de la Unidad

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"

	AREA DE APLICACION	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
	LABORATORIO (URIANALISIS)	15/05/2013	
	NOMBRE DEL MANUAL	Página 15 de 18	
	MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS	CLAVE	VERSIÓN
	CLIENTE	MP-SDADLP-007	0
	TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO	PRODUCTO	
	LECTURA DE ORINAS EN TIRA REACTIVA		

2.- VAMOS A RETIRAR EL CONTENEDOR DE TIRAS USADAS Y ELIMINARLAS EN UN BOTE CON BOLSA ROJA.

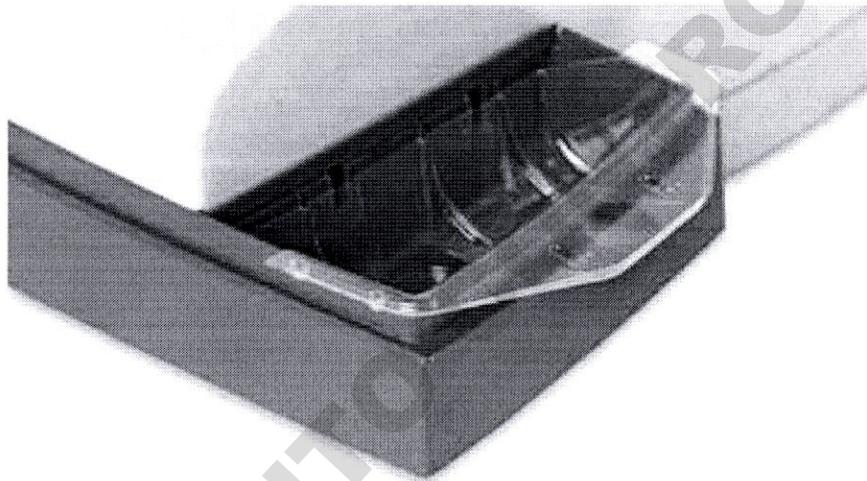


3.- RETIRAMOS LA BARRA IMPULSORA.


Elaboró	Aprobó	Revisó	Autorizó
Dr. En C. Fernando A. Velarde R. Dr. Gustavo R. Rodríguez G.	DR. Luis Alberto Ibarra Verdugo Sub- Director de Diagnóstico y Tto.	Lic. Beatriz Gutiérrez M. Gerente de Calidad	Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa Director de la Unidad

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"

	AREA DE APLICACION	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
	LABORATORIO (URIANALISIS)	15/05/2013	
	NOMBRE DEL MANUAL	Página 16 de 18	
	MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS	CLAVE	VERSIÓN
	CLIENTE	MP-SDADLP-007	0
	TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO	PRODUCTO	
		LECTURA DE ORINAS EN TIRA REACTIVA	

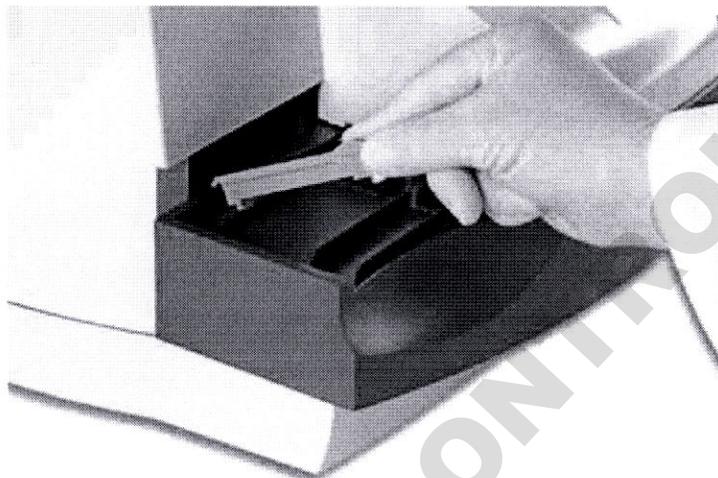

4.-RETIRAMOS LA PLATAFORMA FIJA.

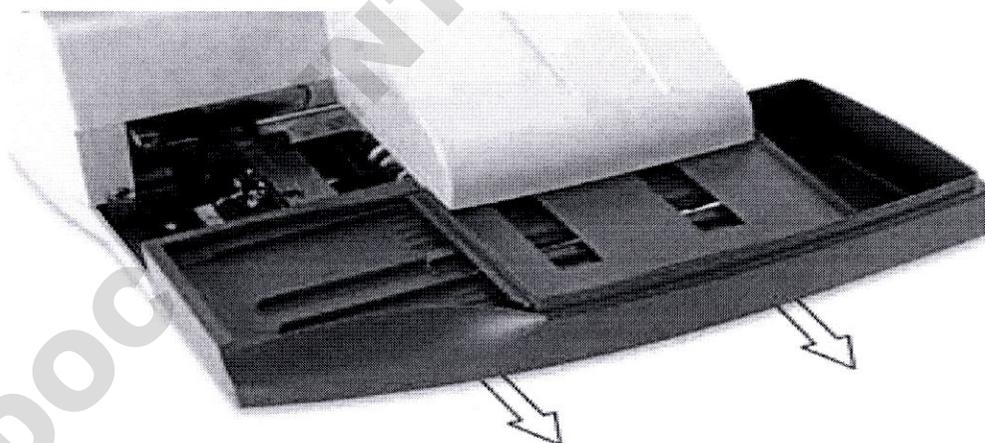


Elaboró	Aprobó	Revisó	Autorizó
Dr. En C. Fernando A. Velarde R. Dr. Gustavo R. Rodríguez G.	DR. Luis Alberto Ibarra Verdugo Sub- Director de Diagnóstico y Tto.	Lic. Beatriz Gutiérrez M. Gerente de Calidad	Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa Director de la Unidad

(Handwritten signatures in blue ink are present over the signature lines and extend across the bottom of the page.)


O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"



	AREA DE APLICACION	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
	LABORATORIO (URIANALISIS)	15/05/2013	
	NOMBRE DEL MANUAL	Página 17 de 18	
	MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS	CLAVE	VERSIÓN
	TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO	MP-SDADLP-007	0
	CLIENTE	PRODUCTO	
TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO	LECTURA DE ORINAS EN TIRA REACTIVA		

5.- RETIRAMOS LA TAPA DE LA PLATAFORMA FIJA O TAMBIEN LLAMADA PLACA DE SUJECION.

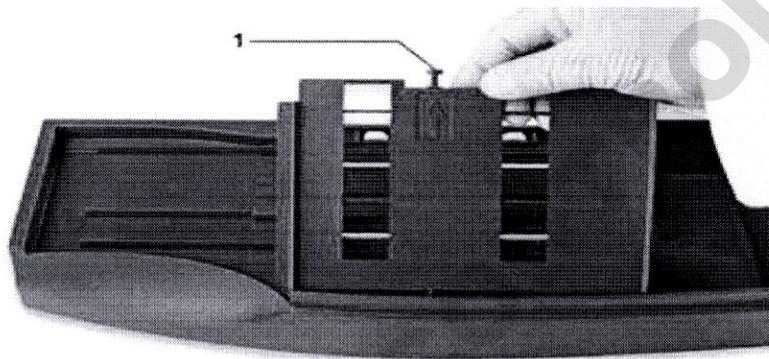

6.- RETIRAMOS LA ESTACION DE CARGA DE TIRAS.

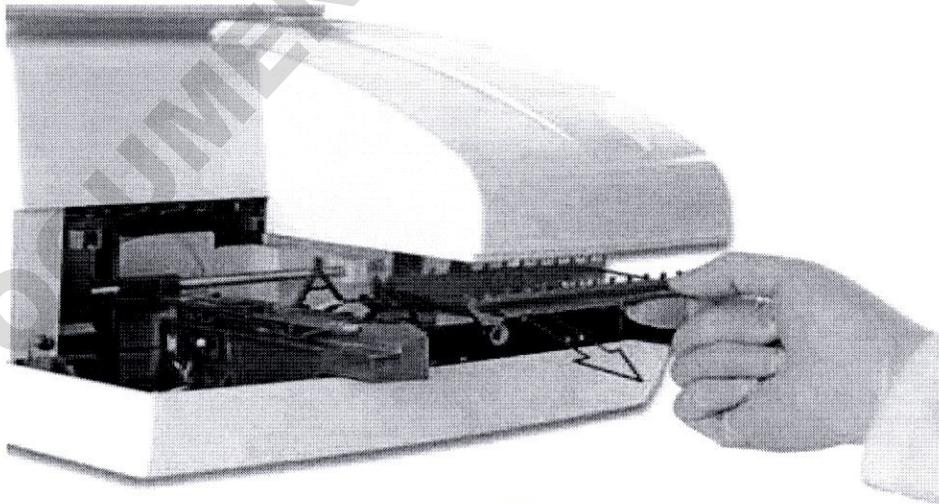

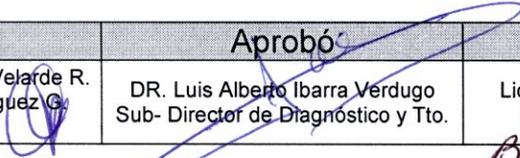 Elaboró Dr. En C. Fernando A. Velarde R. Dr. Gustavo R. Rodríguez G.	 Aprobó DR. Luis Alberto Ibarra Verdugo Sub- Director de Diagnóstico y Tto.	 Revisó Lic. Beatriz Gutiérrez M. Gerente de Calidad	 Autorizó Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa Director de la Unidad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"



	AREA DE APLICACION	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
	LABORATORIO (URIANALISIS)	15/05/2013	
	NOMBRE DEL MANUAL	Página 18 de 18	
	MANUAL TECNICO PARA EL EQUIPO CLINITEK ADVANTUS	CLAVE	VERSIÓN
	CLIENTE	MP-SDADLP-007	0
	TECNICO LABORATORISTA CLINICO O AUXILIAR DE LABORATORIO	PRODUCTO	
	LECTURA DE ORINAS EN TIRA REACTIVA		

7.- VAMOS A COLOCAR 10 LITROS DE AGUA Y LE VAMOS A AGREGAR 100 ML DE SOLUCION ALCALINA AL 25% DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.5 % 10 ML EN UN RECIPIENTE E INTRODUCIMOS TODAS LAS PARTES RETIRADAS DEL EQUIPO Y LO DEJAMOS REPOSAR POR 30 MIN.

8.- SE RETIRAN LAS PIEZAS DEL RECIPIENTE Y SE ENJUAGAN CON ABUNDANTE AGUA DE LA LLAVE Y POSTERIORMENTE SE ENJUAGA CON AGUA DESTILADA Y DESIONIZADA, SE DEJA SECAR A TEMPERATURA AMBIENTE EN UN LUGAR LIMPIO HASTA EL DIA SIGUIENTE PARA SU USO DE NUEVO.

9.- SE LIMPIA CON UN TRAPO HUMEDO EL RESTO DEL EQUIPO.

9. REFERENCIAS

9.1 MANUAL DE PROVEEDOR CLINITEK ADVANTUS SIEMENS

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Fecha del cambio	Descripción de cambios
0	15/05/2013	NUEVA EMISION

Elaboró	Aprobó	Revisó	Autorizó
Dr. En C. Fernando A. Velarde R. Dr. Gustavo R. Rodríguez G.	DR. Luis Alberto Ibarra Verdugo Sub- Director de Diagnóstico y Tto.	Lic. Beatriz Gutiérrez M. Gerente de Calidad	Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa Director de la Unidad

B. Gutiérrez